


4 Pulizia del basamento

La manutenzione del basamento si limita ad una pulizia regolare.


Pulizia esterna

- Getto d'acqua fino a 60 °C.
- Usuali detersivi per uso domestico: disinfettanti e detersivi devono essere utilizzati solo secondo le avvertenze e le prescrizioni dei relativi produttori.
- Ambiente corrosivo: tutte le sostanze corrosive devono essere eliminate con assoluta regolarità.

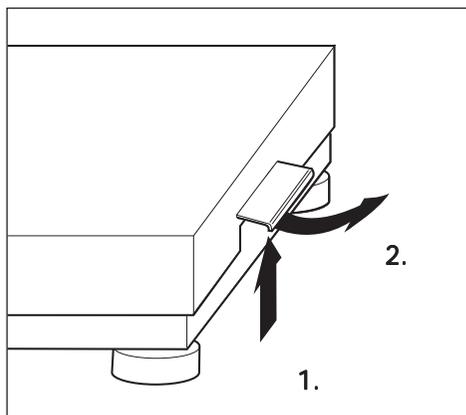

Pulizia interna

- Rimuovere regolarmente lo sporco ed eventuali depositi nell'interno del basamento. A tale scopo, togliere la piattaforma di pesata. Nel caso dei basamenti DCC, per togliere la piattaforma di pesata sollevare verticalmente le due maniglie laterali (1.), quindi ruotarle verso l'esterno (2.).
- Allontanare lo sporco con un soffio d'aria, oppure
- pulire con un getto d'aria non troppo forte.

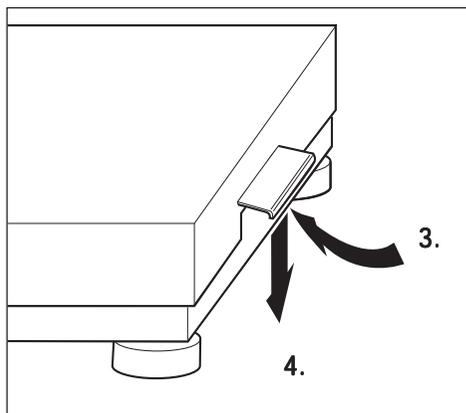

- Riapplicare la piattaforma di pesata. Nei basamenti DCC, dopo aver riapplicato la piattaforma di pesata, ruotare le due maniglie laterali verso l'interno (3.), e riportarle nella posizione di partenza (4.). Le due maniglie devono trovarsi nella posizione in basso e disposte verticalmente. Dopo aver reinserito le maniglie, la piattaforma di pesata non può più essere tolta tirandola verso l'alto.

Indice

1	Dichiarazione di conformità	2
2	Avvertenze di sicurezza	2
3	Limiti d'uso	3
4	Pulizia del basamento	4
5	Accessori	5

1 Dichiarazione di conformità

Noi, **Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH**
 Unter dem Malesfelsen 34
 72458 Albstadt

dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che i prodotti

DB30sT/DB60sT
DCC150sT/DCC300sT
 a partire dal numero di serie 2040015

alle quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle seguenti norme:

EN 45501
EN 50081-1
EN 50082-1
EN 60950


secondo la direttiva del Consiglio 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e la direttiva del Consiglio 73/23/CEE sulle apparecchiature elettriche per impiego entro determinati limiti di tensione.

Albstadt, 3 Aprile 1995 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

2 Avvertenze di sicurezza




- Non utilizzare in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non usare in zone a potenziale rischio d'esplosione per gas, vapori, e nebbie, nonché polveri.

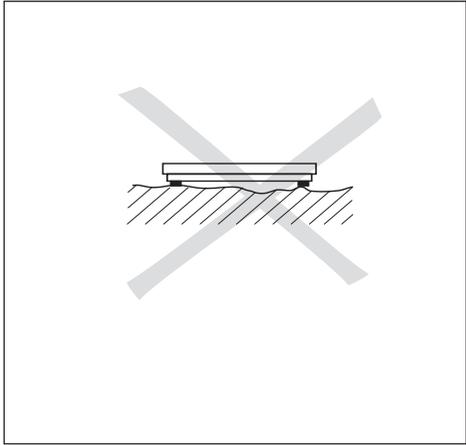

Sceita del luogo d'installazione


- Il sottofondo del luogo d'installazione deve essere tale da supportare senza problemi il peso del basamento caricato al massimo, in corrispondenza di tutti i punti d'appoggio.
- Inoltre, il sottofondo del luogo d'installazione deve essere sufficientemente stabile da evitare il verificarsi d'oscillazioni durante le operazioni di pesata. Queste condizioni devono essere rispettate anche in caso d'inserimento del basamento in sistemi trasportatori e simili.

3 Limiti d'uso

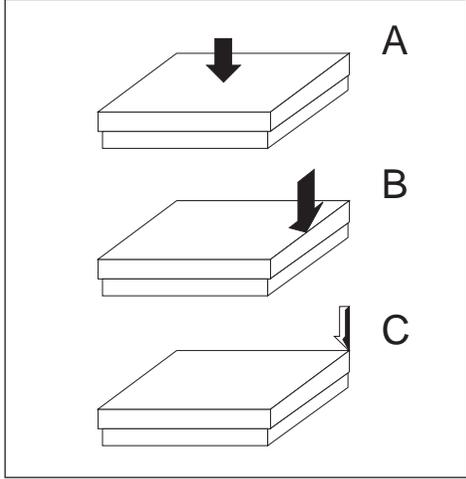

I basamenti sono costruiti con la massima robustezza, per cui anche un occasionale superamento della portata non provoca alcun danneggiamento. In funzione del tipo di distribuzione del carico, la portata statica, cioè il carico massimo ammesso è:

Carico	DB30sT	DCC150sT
	DB60sT	DCC300sT
A con carico centrato uniformemente distr.	120 kg	500 kg
B con carico laterale centrato	80 kg	300 kg
C con carico unilaterale su un angolo	40 kg	150 kg

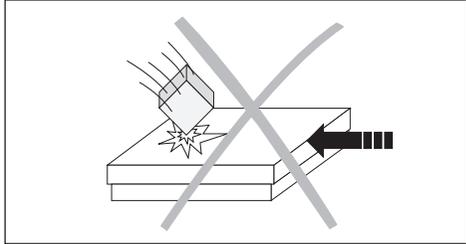

- Evitare la caduta di carichi, sollecitazioni ad urto e urti laterali.


Istruzioni d'uso

METTLER TOLEDO MultiRange Bilance a cavalletto DB30sT / DB60sT DCC150sT / DCC300sT

METTLER TOLEDO

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, D-72458 Albstadt, Germany, Tel. (0 74 31) 14-0, Fax (0 74 31) 14-232

A Mettler-Toledo Ges.m.b.H., 1100 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80
AUS Mettler-Toledo Ltd., Victoria 3207, Tel. (3) 646 45 51, Fax (3) 645 39 35
B N.V. Mettler-Toledo S.A., 1651 Lot, Tél. (02) 3340211, Fax (02) 3781665
CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG, 8606 Greifensee, Tel. (01) 944 45 45, Fax (01) 944 45 10
CN Mettler-Toledo (Shanghai) Ltd., Shanghai 200233, Tel. (21) 470 3932, Fax (21) 470 3351
D Mettler-Toledo GmbH, 35353 Giessen 11, Tel. (0641) 507-0, Fax (0641) 5 29 51
DK Mettler-Toledo A/S, 2100 Copenhagen Ø, Tel. (39) 29 04 00, Fax (39) 29 04 26
E Mettler-Toledo S.A.E., 08038 Barcelona, Tel. (93) 223 22 22, Fax (93) 223 02 71
F Mettler-Toledo s.a., 78220 Viroflay, Tél. (1) 30 97 17 17, Fax (1) 30 97 16 16
HK Mettler-Toledo PacRim Ltd., Kowloon, Hongkong, Tel. 724 23 48, Fax 724 23 49
I Mettler-Toledo S.p.A., 20026 Novate Milanese, Tel. (02) 33332.1, Fax (02) 35 62 973
J Mettler-Toledo K.K., Takarazuka 665, Tel. 797 74 2406, Fax 797 74 2641
N Mettler-Toledo A/S, 1008 Oslo 10, Tel. (22) 30 44 90, Fax (22) 32 70 02
NL Mettler-Toledo B.V., 4000 HA Tiel, Tel. (03440)11311*, Fax (03440) 20530
S Mettler-Toledo AB, 120 08 Stockholm, Tel. (08) 702 50 00, Fax (08) 642 45 62
SGP Mettler-Toledo (S.E.A.) Pte. Ltd., Singapore 0513, Tel. 0065 778 67 79, Fax 0065 778 66 39
TH Mettler-Toledo (Thailand), Bangkok 10310, Tel. 719 64 80-87, Fax 719 64 79
UK Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW, Tel. (0116) 235 7070, Fax (0116) 236 6399
USA Mettler-Toledo Inc., Worthington, Ohio 43085, Tel. (614) 438-4511, Fax (614) 438-4755
USA Mettler-Toledo, Inc., Highstown, NJ 08520-0071, Tel. (609) 448-3000, Fax (609) 586-5451
For all other countries: Mettler-Toledo AG, VI, 8606 Greifensee, Tel. 01/944 22 11, Fax 01/944 31 70

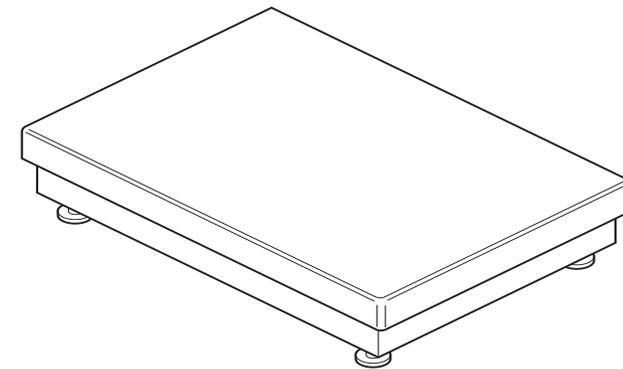

5 Accessori

	Cod. Ord.	
	DB30sT	DCC150sT
	DB60sT	DCC300sT
Cavalletto		
Struttura a telaio stabile, due piedini con rotelle, un piedino fisso con vite di regolazione, altezza circa 560 mm		
– nero, con rivestimento di plastica	503 631	504 853
– in acciaio inossidabile	503 632	504 854
Convogliatore a rulli		
8 rulli con mantello d'acciaio, direzione longitudinale, in acciaio inossidabile	503 640	504 852