


Installation Instructions **Antistatic Kit for XP Analytical Balances**  
 Montageanleitung **Antistatik Kit für XP Analysenwaagen**  
 Notice de montage **Kit antistatique pour les balances d'analyse XP**  
 Instrucciones de montaje **Kit antiestático para balanzas analíticas XP**  
 Istruzioni di montaggio **Kit antistatico per bilance analitiche XP**

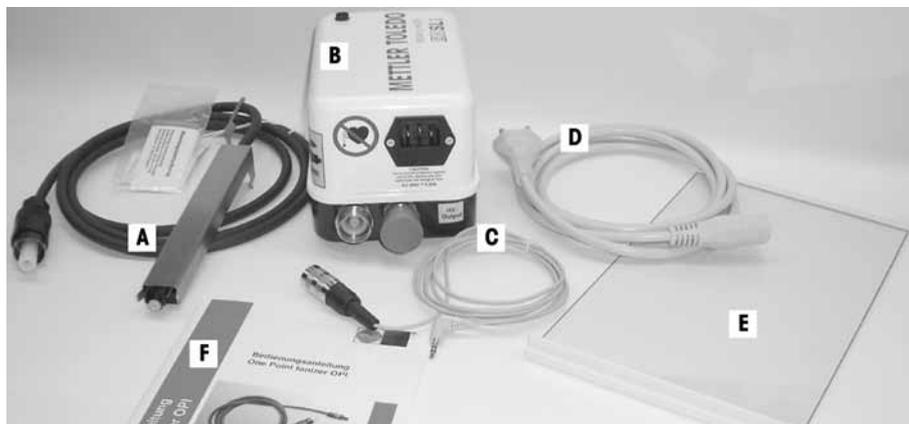

**Components**

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> Single-point ionizer | <b>B</b> AC adapter             |
| <b>C</b> Control cable        | <b>D</b> Power supply cable     |
| <b>E</b> Side door            | <b>F</b> Operating Instructions |

**Note**

Position the single-point ionizer on the left or right side of the balance.  
The AC adapter can have two single-point ionizers connected to it.

English

**Komponenten**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> Einpunkt-Ionisor | <b>B</b> Netzteil            |
| <b>C</b> Steuerkabel      | <b>D</b> Netzkabel           |
| <b>E</b> Seitentüre       | <b>F</b> Bedienungsanleitung |

**Hinweis**

Positionieren Sie den Ein-Punkt-Ionisor auf der linken oder rechten Seite der Waage.  
Es ist möglich zwei Ein-Punkt-Ionisatoren am Netzteil anzuschliessen.

Deutsch

**Composants**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> Ionisateur ponctuel | <b>B</b> Bloc d'alimentation secteur |
| <b>C</b> Câble de commande   | <b>D</b> Câble secteur               |
| <b>E</b> Vitre latérale      | <b>F</b> Mode d'emploi               |

**Remarque**

Positionnez l'ionisateur ponctuel sur le côté gauche ou droit de la balance.  
Il est possible de raccorder deux ionisateurs ponctuels au bloc d'alimentation secteur.

Français

**Componentes**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Ionizador de punto | <b>B</b> Adaptador de alimentación |
| <b>C</b> Cable de mando     | <b>D</b> Cable de red              |
| <b>E</b> Puerta laterale    | <b>F</b> Instrucciones de manejo   |

**Advertencia**

Coloque el ionizador de punto en el lado izquierdo o derecho de la balanza.  
Es posible conectar dos ionizadores de punto al adaptador de alimentación.

Español

**Componenti**

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> Ionizzatore a punto | <b>B</b> Alimentatore di rete |
| <b>C</b> Cavo di controllo   | <b>D</b> Cavo di rete         |
| <b>E</b> Portina laterale    | <b>F</b> Istruzioni d'uso     |

**Nota**

Posizionare il ionizzatore a punto sul lato destro o sinistro della bilancia.  
È possibile collegare all'alimentatore di rete due ionizzatori.

Italiano

**CAUTION****Damage of Device**

The power cable used to connect the ionizer must have a ground wire and be plugged into an outlet with a functioning ground connection.

**VORSICHT****Beschädigung des Instruments**

Das Gerät muss mit einem Netzkabel mit Erdleiter an eine Steckdose mit funktionierendem Erdleiter angeschlossen werden.

**PRUDENCE****Dommages à l'appareil**

L'appareil doit être raccordé à l'aide d'un câble secteur avec conducteur de terre à une prise secteur reliée à un conducteur de terre qui remplit sa fonction.

**PRECAUCIÓN****Daños en el equipo**

El equipo debe conectarse con un cable de red con conductor de puesta a tierra a un enchufe hembra con un conductor de puesta a tierra que funcione.

**ATTENZIONE****Danni al dispositivo**

Collegare l'impianto a una presa con filo di terra funzionante utilizzando un cavo di alimentazione dotato di filo di terra.

---

**DANGER****Persons with cardiac pacemakers**

Persons with cardiac pacemakers must always maintain a safety distance **of more than 50 cm** from the ionizer.

**GEFAHR****Personen mit Herzschrittmachern**

Personen mit Herzschrittmachern müssen vom Ionisator einen Sicherheitsabstand **von mehr als 50 cm** einhalten.

**DANGER****Personnes équipées d'un pacemaker**

Les personnes équipées d'un pacemaker doivent respecter un écart de sécurité **de plus de 50 cm** par rapport à l'ionisateur.






**PELIGRO****Personas que lleven marcapasos**

Las personas que lleven marcapasos deben guardar una distancia de seguridad **de más de 50 cm** del ionizador.

**PERICOLO****I portatori di pacemaker**

I portatori di pacemaker devono mantenere una distanza di sicurezza **di almeno 50 cm** dal ionizzatore.

---

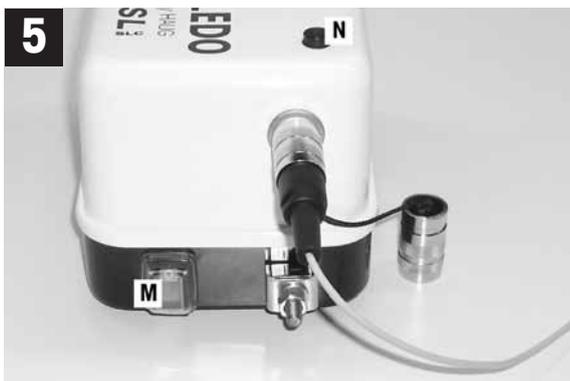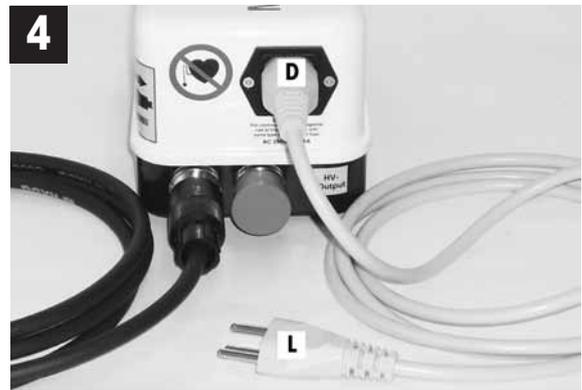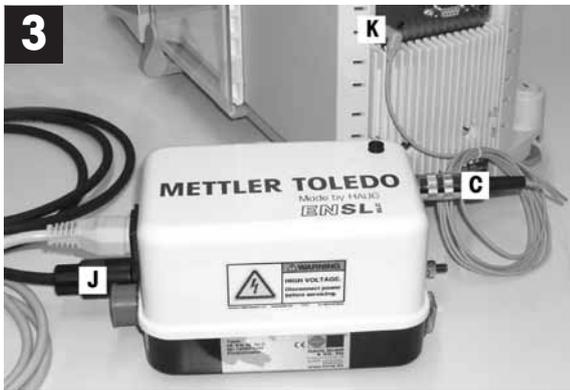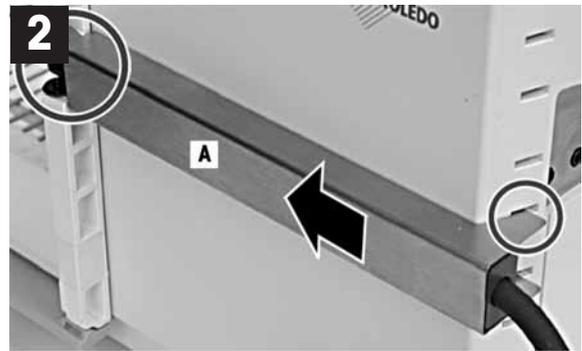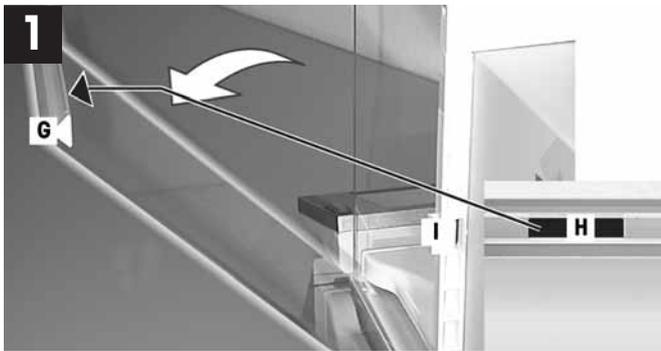

### English

- 1 • Swap the side door (G) for the door (E) marked with "Conducting Glass" (H) supplied with the antistatic kit.
  - Pull the middle clip (I) (recommended position) off.
- 2 • Push the point ionizer (A) in from the back. If necessary, slightly bend the strips so that the ionizer is held firmly.
- 3 • Screw the ionizer cable (J) tightly onto the AC adapter.
  - Screw in the control cable (C).
  - Plug the control cable into Aux 1 or Aux 2 (K).
- 4 • Plug in power cable (D).
  - Connect power cable (L) to power supply.
- 5 • Switch On/Off (M).
  - ⇒ Control lamp (N) lit when the ionizer is active.

Information about settings for the antistatic kit is contained in the operating instructions for XP analytical balances.

### Deutsch

- 1 • Tauschen Sie die Seitentüre (G) gegen die mitgelieferte Türe (E) bezeichnet mit "Conducting Glass" (H) aus dem Antistatik Kit aus.
  - Mittleren Clip (I) (empfohlene Position) wegziehen.
- 2 • Punkt Ionisator (A) von hinten einschieben. Eventuell Laschen leicht biegen damit ein satter Halt gewährleistet ist.
- 3 • Ionisatorkabel (J) am Netzteil festschrauben.
  - Steuerkabel (C) einschrauben.
  - Steuerkabel einsetzen Aux 1 oder Aux 2 (K).
- 4 • Netzkabel (D) einstecken.
  - Netzkabel (L) an das Netz anschliessen.
- 5 • Drücken Sie On/Off (M).
  - ⇒ Kontrolllampe (N) leuchtet bei aktivem Ionisator.

Einstellungen für den Antistatik Kit entnehmen Sie Ihrer Bedienungsanleitung für XP Analysenwaagen.

## Français

- Echangez la porte latérale (G) contre la porte (E) marquée avec "Conducting Glass" (H) livrée dans le kit antistatique.
  - Retirez le clip médian (I) (position recommandée).
- Glissez l'ionisateur ponctuel (A) par l'arrière. Pliez éventuellement les languettes afin d'obtenir un maintien ferme.
- Vissez le câble du ionisateur (J) au bloc d'alimentation secteur.
  - Vissez le câble de commande (C).
  - Insérez le câble de commande au connecteur Aux 1 ou Aux 2 (K).
- Enfichez le câble secteur (D).
  - Raccordez le câble secteur (L) au secteur.
- Appuyez sur la touche On/Off (M).
  - ⇒ Voyant de contrôle (N) allumé si ionisateur actif.

Pour les paramétrages du kit antistatique, consultez le mode d'emploi des balances d'analyse XP.

## Italiano

- Sostituire la finestra laterale (G) con la finestra (E) marcata con "Conducting Glass" (H) fornita nel kit antistatico.
  - Estrarre la clip centrale (I) (posizione consigliata).
- Inserire dal retro le ionizzatore a punto (A). Piegando eventualmente le linguette in modo da garantire una posizione ben ferma.
- Avvitare il cavo del ionizzatore (J) all'alimentatore.
  - Inserire il cavo di controllo (C).
  - Introdurre il cavo di controllo Aux 1 o Aux 2 (K).
- Inserire il cavo di rete (D).
  - Collegare il cavo di rete (L) alla rete.
- Premere On/Off (M).
  - ⇒ Spia di controllo (N) si accende quando il ionizzatore è attivo.

Utilizzare le impostazioni per il kit antistatico illustrate nelle istruzioni per l'uso della bilancia analitica XP.

## Español

- Intercambie la puerta lateral (G) con la puerta (E) marcado con "Conducting Glass" (H) suministrada con el kit antiestático.
  - Retire la pinza del centro (I) (posición recomendada).
- Introduzca el ionizador de punto (A) deslizándolo desde atrás. Si es necesario, doble ligeramente las lengüetas para garantizar una mejor sujeción.
- Atornille el cable del ionizador (J) al adaptador de alimentación.
  - Atornille el cable de mando (C).
  - Monte el cable de mando en la entrada Aux 1 o Aux 2 (K) de la balanza.
- Conecte el cable de red (D).
  - Enchufe el cable de red (L) a la red de alimentación.
- Pulse On/Off (M).
  - ⇒ Piloto (N) se enciende cuando el ionizador está activo.

Puede consultar la configuración para el kit antiestático en el manual de instrucciones de su balanza analítica XP.

	Spare Parts	Ersatzteile	Pièces de rechange	Piezas de recambio	Pezzi di ricambio
1 1 1 06263	Side door	Seitentüre	Vitre latérale	Puerta laterale	Portina laterale
30038085	Control cable	Steuerkabel	Câble de commande	Cable de mando	Cavo di controllo
1 1 1 07763	Power supply ASK-XP	Netzteil ASK-XP	Alimentation secteur ASK-XP	Adaptador de alimentación ASK-XP	Alimentatore di rete ASK-XP

[www.mt.com/excellence](http://www.mt.com/excellence)

For more information

### Mettler-Toledo AG

Laboratory & Weighing Technologies  
CH-8606 Greifensee, Switzerland  
Phone +41 44 944 22 11  
Fax +41 44 944 30 60

Subject to technical changes  
© Mettler-Toledo AG 02/2012  
30038450 en, de, fr, es, it



\* 3 0 0 3 8 4 5 0 \*